

Materialanforderung für Zytologie und HPV


Praxis (Stempel)

Datum _____

Techn. Bereich (Prä-/Postanalytik)

Telefax: 089 122 860 862

Email: praxis@weyerstahl.de

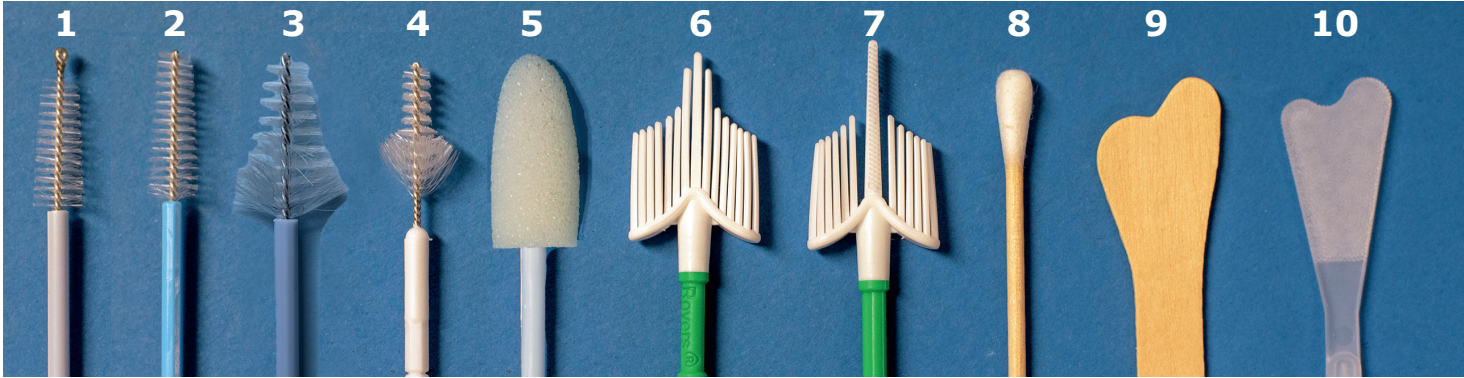



Auch wenn die KV-Richtlinien den Spatel favorisieren, bedenken Sie bitte, dass damit häufig techn. insuffiziente Abstriche (zu dick, zu blutig) angefertigt werden!

Bitte übersenden Sie uns:

Abstrich-träger	Cytobrush Plus (Nr. 1)	Gynobrush (Nr. 2)	Gynobrush spezial (Nr. 3)	Cervibrush Profil (Nr. 4)	PapCone (Nr. 5)	Cervex-brush (Nr. 6)	Cervexbrush combi (Nr. 7)	Watteträger (Nr. 8)	Holzspatel (Nr. 9)	Plastikspatel (Nr. 10)
Anzahl										

Objektträger	96%iger Alkohol zur Fixierung (2,5l)	96%iger Alkohol zur Fixierung (5l)	Cyto-Fixx Spray (150ml)	Hellendahl Gefäß zur Fixierung	Thin Prep Töpfchen (vial)	Kombi. Ü-Schein (gelb) Muster 10	Material-anforderungsschein	EILT-Aufkleber
Anzahl								

Container f. Objektträger	Versand-mappen (Pappe)	Versand-taschen	Versandtüten (blau)	Info-Flyer Thin Prep	Info-Flyer HPV-Test
Anzahl					

Barcoderolle		Laborbuch (Ausgangs-/Eingangskontrolle für die Praxis)	
Anzahl			

Wir benötigen die Ware spätestens am: _____

amedes MVZ für Gynäkologie & Pathologie
Dr. Thomas Weyerstahl & Koll.

Zytologisches & molekularbiolog. Labor
Dysplasie-Einheit München

Maximilianstr. 38 - 40

80539 München